

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告


检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098 号

检验日期: 2025.06.13

试剂批号:

22506101

检测项目	要求	检测方法			
		原理	试剂	仪器	判定标准
外观	澄清透明, 不得有沉淀、凝块或絮状物	目视	无	无	无
pH 值	7.00 ± 0.02	pH 计	无	无	无
渗透压	$270 \pm 10 \text{mOsm/L}$	渗透压计	无	无	无
电导率	$150 \pm 10 \mu\text{S/cm}$	电导率计	无	无	无
细菌内毒素	$\leq 0.25 \text{EU/mL}$	凝胶法	无	无	无
热原	无	鲎试剂法	无	无	无

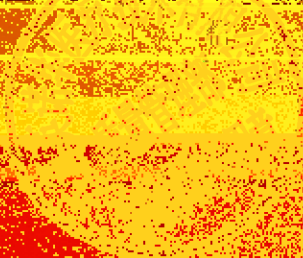

检测人:

审核人:

检测日期: