


编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液
检验日期: 2025.11.24

试剂批号: 22511191
试剂规格: 1000ml

项目	技术要求	检测结果	判定	备注	
外观	无色透明水溶液, 无可见杂质, 无刺激性气味	合格	合格		
pH值	不低于指示值	7.20	合格		
电导率	25±1℃, $pH > 12$, 25±1℃, $pH < 8.00 \pm 0.05$, 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, $pH < 8.00 \pm 0.05$ EDTA-2Na 细胞计数用清洗液: 25±1℃, $pH < 8.00 \pm 0.05$	合格	合格		
细菌数	EDTA-2Na 细胞计数用清洗液: $CFU < 3.0 \times 10^3$ / L 血小板分析仪专用清洗液: $CFU < 0.05 \times 10^3$ / L EDTA-2Na 细胞计数用清洗液: $CFU < 0.05 \times 10^3$ / L	0.01	0.00	0.00	0.00
内毒素	血小板分析仪专用清洗液: $EU < 1.0 \times 10^3$ / L EDTA-2Na 细胞计数用清洗液: $EU < 1.0 \times 10^3$ / L EDTA-2Na 细胞计数用清洗液: $EU < 1.0 \times 10^3$ / L	0	0	0	0
其他	符合国家标准				

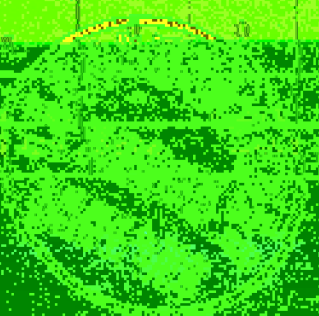

YNH 1000ml